



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0599

检测报告

编号

日期

第 1 页 共 5 页

Test Report

No. SL520352854105TX

Date: 2020-9-7

Page 1 of 5

下列样品由客户提供及确认为:

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

客户信息 Client Information	委托单位: Consignor:	新洲印刷(辽宁)有限公司 New Island Printing (Liaoning) Co., Ltd		
	委托单位地址: Consignor address:	辽宁营口市西市区新民大街 17 号 17 XINMIN DAJIE, XICHENG DISTRICT, YINGKOU CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA		
样品信息 Sample information	样品描述: Sample Description:	医用外科口罩: 颜色为蓝色。 Surgical Mask: in blue.		
	SGS 号: SGS No.:	CP20-041306		
	生产单位: Manufacture:	新洲印刷(辽宁)有限公司 New Island Printing (Liaoning) Co., Ltd		
	规格型号: Size:	17.0cm×9.5cm 平面形耳挂式		
	样品数量: Sample Quantity:	120 个(4 盒) 120 pieces (4 packages)		
检验信息 Test Information	检测类别: Test Type:	委托送样检验 Submitted (sample sent by client)		
	样品送达日期: Sample Received Date:	2020-08-10	检测周期: Test Period:	2020-08-10~2020-09-07
	检测依据: Testing Accordance:	详见结果检测页 See the result pages		
	判定依据: Document Accordance	客户要求: YY 0469-2011 医用外科口罩 Client's requirement: YY 0469-2011 Surgical mask		
检测结论: Test Conclusion	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果页。 The report only give the test result and individual judgment, details please see follow page.			



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取, 请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com



检测报告

编号

日期

第 2 页 共 5 页

Test Report

No. SL520352854105TX

Date: 2020-9-7

Page 2 of 5

通标标准技术服务(上海)有限公司

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd

批准人签署 Approved by:

批准人签署 Approved by:

崔小英 Ellen Cui

轩海连 Helen xuan

(授权签字人 Authorized Signatory)

测试结果仅对来样负责

This test report refer only to the samples tested



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

检测结果及评判
Test Results and Judgement

YY 0469-2011 检测项目 Test items:

序号 No.	检测项目及测试方法 Test Items & Test Methods	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results		单项判定 Individual Judgment
1.	外观 Appearance (YY 0469-2011 5.1)	-	口罩外观应整洁、形状完好， 表面不得有破损、污渍 Neat, shape intact, no break, stain on surface.	试样 1 Specimen 1	符合要求 Meet Requirement	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	符合要求 Meet Requirement	
				试样 3 Specimen 3	符合要求 Meet Requirement	
2.	结构与尺寸 Shape and size (YY 0469-2011 5.2)	-	口罩佩戴好后，应能罩住佩戴 者的鼻、口至下颌 Cover up mouth, nose and lower jaw after mask wearing.	试样 1 Specimen 1	符合要求 Meet Requirement	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	符合要求 Meet Requirement	
				试样 3 Specimen 3	符合要求 Meet Requirement	
			应符合标志的设计尺寸及允 差。 Meet design dimensions and tolerance.	试样 1 Specimen 1	17.8×9.6cm	-
				试样 2 Specimen 2	17.8×9.6cm	
				试样 3 Specimen 3	17.8×9.6cm	
3.	鼻夹 Noseclip (YY 0469-2011 5.3)	-	口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可 塑性材料制成 Noseclip on mask, noseclip be made of plastic material.	试样 1 Specimen 1	符合要求 Meet Requirement	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	符合要求 Meet Requirement	
				试样 3 Specimen 3	符合要求 Meet Requirement	
			鼻夹长度应不小于 8.0 cm Length of noseclip no less than 8.0cm.	试样 1 Specimen 1	9.8 cm	
				试样 2 Specimen 2	9.8 cm	
				试样 3 Specimen 3	10.0 cm	



序号 No.	检测项目及测试方法 Test Items & Test Methods	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results		单项判定 Individual Judgment
4.	口罩带 Mask strip (YY 0469-2011 5.4)	-	口罩带应带取方便 Mask strip wearing convenient.	试样 1 Specimen 1	符合要求 Meet Requirement	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	符合要求 Meet Requirement	
				试样 3 Specimen 3	符合要求 Meet Requirement	
			每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N The force of mask strip and body connection point no less than 10N.	左试样 1 Left Specimen 1	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected	
				左试样 2 Left Specimen 2	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected	
				左试样 3 Left Specimen 3	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected	
				右试样 1 Right Specimen 1	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected	
				右试样 2 Right Specimen 2	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected	
右试样 3 Right Specimen 3	10N 拉力, 保持 5s,样品未断裂 10N static tension for 5s, the sample did not detected					
5.	细菌过滤效率 Bacterial filtration efficiency (YY 0469-2011 5.6.1)	%	≥95	试样 1 Specimen 1	99.9	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	99.9	
				试样 3 Specimen 3	99.7	
6	环氧乙烷残留量 Ethylene oxide residue (YY 0469-2011 GB/T 14233.1-2008) 检测限 MDL: 5µg/g	µg/g	≤10	未检出 Not detection		符合 Pass
7	颗粒过滤效率 Particle filtration efficiency (YY 0469-2011 5.6.2)	%	≥30	试样 1 Specimen 1	95.546	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	96.364	
				试样 3 Specimen 3	96.123	




除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx> 获取, 请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测样品, 此样品只保留30天。
 注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

序号 No.	检测项目及测试方法 Test Items & Test Methods	单位 Unit	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项判定 Individual Judgment	
8	压力差 Pressure difference (YY 0469-2011 5.7)	Pa/cm ²	≤49	47	符合 Pass	
9	合成血液穿透 Synthetic blood penetration (YY 0469-2011 5.5)	-	将 2mL 合成血液以 16.0kpa (120mmHg) 压力喷向口罩外侧, 口罩内侧不应出现渗透 Spray 2ml synthetic blood to the mask at 16.0kpa (120mmHg), no infiltration inside of mask.	1 号 No.1	无血液穿透 no infiltration inside of mask	符合 Pass
				2 号 No.2	无血液穿透 no infiltration inside of mask	
				3 号 No.3	无血液穿透 no infiltration inside of mask	
10	阻燃性能 Burning behaviour (YY 0469-2011 5.8)	s	口罩离开火焰后燃烧应≤5 the mask shall not continue to burn for more than 5 s after removal from the flame.	试样 1 Specimen 1	0 s	符合 Pass
				试样 2 Specimen 2	0 s	
				试样 3 Specimen 3	0 s	
11	微生物指标-无菌测试 Microorganism test Sterility test (GB/T 14233.2-2005)	-	不生长 Sterile	未生长 No growth	符合 Pass	

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

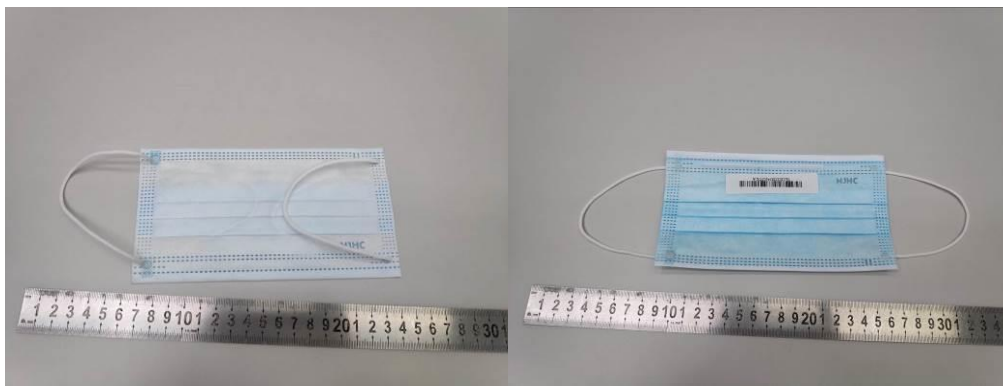

报告结束

End of report



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com